

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 071650

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8190 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : RETRAITE
Nom & Prénom : FASSI FILTRI HASSAN
Date de naissance : 29/05/68
Adresse : 46 RUE ATLAS HAY SAZAM
CASABLANCA
Tél. : 0661196605 Total des frais engagés : 815804 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : [Stamp]
Date de consultation : 13/08/2021
Nom et prénom du malade : FASSI FILTRI HASSAN
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Malade / H2A / 12202
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel au médecin conseil de la Mutuelle.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente.
Fait à : Casablanca Le : 15/08/2021
Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/08/2014			3000	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
pharmacie HOUR KABBAJ Soumia 10 Bd. Yacoub El Manssour et Sidi Abderrahman - Casablanca Tel: 0522 35 89 11	13/08/2021	4658,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	13/08/91	B150+ PC	2100 DH
	13/08/91	B130+PC	300 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
13/08/2021 ARCC DIABETE Plus Dr. Abou Assalt Al Andaloussi Marrakech - Casablanca 05 22 98 45 89 Pharmacie Commerciale	13/08/2021					800v

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION

O.D.F		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE													
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">H</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412 00000000</td> <td style="text-align: center;">21433552 00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000 35533411</td> <td style="text-align: center;">00000000 11433553</td> </tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">B</td></tr> </table>		H		25533412 00000000	21433552 00000000	D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX	
		H													
		25533412 00000000	21433552 00000000												
		D	G												
00000000 35533411	00000000 11433553														
B															
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS													
		DATE DU DEVIS													
		DATE DE L'EXECUTION													

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUT

Docteur Bennani Abdelilah

Cabinet Médical spécialisé en :

- ENDOCRINOLOGIE

- DIABETE

- NUTRITION

(Sur Rendez-Vous)



الدركتور بناني عبد الله

استشارة تخصصية في :

الهرمونية

كري

ذية

(عد

Casablanca, le :

17 / 08 / 2017

nn feni felni henn

Bandelette reedus ASS x 33

galvus 50

Jardiance 25

Mebilet 5

Tareg 160

erpan











n:

Lundi - Vendredi : 9h - 17h

Samedi (matinée) : 9h - 13h

خامس، السابق الثاني، رقم 5 - (قرب ساحة آل ياسر)
(à côté du Rond Point Albert 1^{er}) Casablanca - Tél./Fax

GSM : 06 63 08 09 47 - Email : abdel.henn@hotmail.fr

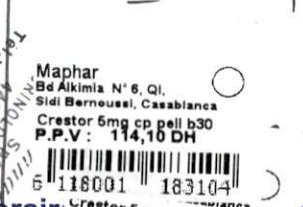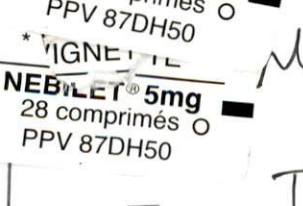

INP : 09 10 244 89

390,00 x 5

390,00 x 3

87,80 x 2

180,30 x 3

124,10 x 3

46,58 x 20

05 22 40 33 34 / 35

433, Bd. Mohammed V, 2^{ème}

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Pour usage diagnostique in vitro

Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
- Ne pas réfrigérer.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



Utiliser avec **Rightest® GM260**

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Pour usage diagnostique in vitro

Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
- Ne pas réfrigérer.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C



30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Pour usage diagnostique in vitro

Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
- Ne pas réfrigérer.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



Utiliser avec **Rightest® GM260**

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C



30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assâti Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C



30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C



30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél: 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax: 05.22.98.45.89
Email: marocdiabete@menara.ma

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang. Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellement.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C - 30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assâti Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél: 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax: 05.22.98.45.89
Email: marocdiabete@menara.ma

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C



30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél: 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax: 05.22.98.45.89
Email: marocdiabete@menara.ma

101-2GS260-092
FR

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212073001



BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

GS260



Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME
Bandelettes de test de glycémie

- Pour usage diagnostique in vitro
Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle
- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
 - Ne pas réfrigérer.
 - Lire la notice avant la première utilisation.
 - Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
 - Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
 - Ne pas utiliser en cas de rupture du scellément.
 - Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



4°C - 30°C



Utiliser avec **Rightest® GM260**



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assâf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél: 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax: 05.22.98.45.89
Email: marocdiabete@menara.ma

101-2GS260-092
FR

BIONIME

Bandelettes de test de glycémie

Instructions d'utilisation GS260



1. Insérez la bande dans la prise sur le haut de l'appareil et attendez que les informations sur la glycémie compteur LCD apparaissent.



2. Après l'obtention d'un échantillon de sang sur votre doigt, touchez délicatement la pointe de la bande pour que l'échantillon de sang puisse être absorbé.

Rightest® GS260



MAROC DIABETE PLUS
99, Rue Abou Assaïf Alandaloussi
Quartier Maarif - Casablanca
Tél : 05.22.23.76.76 - 05.22.23.75.24
Fax : 05.22.98.45.89
Email : marocdiabete@menara.ma

BIONIME

Bandelettes de test de glycémie

Caractéristiques:

- Un design convivial.
- La nécessité d'un petit échantillon de sang.
- Moins de sang signifie moins de douleur
- Bandelettes de test à électrodes en or, effectuées sous haute précision et exactitude.

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
http://www.bionime.com
E-mail: info@bionime.com



BIONIME GmbH

Tramstrasse 16, 9442 Berneck / Suisse
E-mail: info@bionime.ch



GM260
utiliser avec
GS260

BIONIME

Bandelettes de test de glycémie



LOT

2022-07-05
212075001



GS260



BIONIME

Bandelettes de test de glycémie

25 PCS (1 flacon de 25)

Bandelettes de test à électrodes en or

Rightest® GS260

BIONIME

Bandelettes de test de glycémie

Pour usage diagnostique in vitro

Pour l'auto-test et l'utilisation professionnelle

- Conserver à une température comprise entre 4 °C et 30 °C (39 °F et 86 °F)
- Ne pas réfrigérer.
- Lire la notice avant la première utilisation.
- Utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture du flacon de la bandelette.
- Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée.
- Ne pas utiliser en cas de rupture du scellement.
- Jeter les bandelettes de test correctement après un usage unique.



Utiliser avec **Rightest® GM260**

101-2GS260-092
FR

Docteur. Bennani Abdelilah

Cabinet Médical spécialisé en :

- ENDOCRINOLOGIE

- DIABETE

- NUTRITION

(Sur Rendez-Vous)



الدكتور بناني عبد الله

عيادة متخصصة في :

- أمراض الغدد الهرمونية

- السكري

- التغذية

(بالموعد)

Casablanca, le :

17/8/21

ma Famille Aït M'hammed

glycémie

HbA1c

cholestérol

ds (mm - mm) - TS

trans lipides

ACE

CA12 - 9

PJA

niwa 244

kuoby, m'h. Courp, 12

Horaire de Consultation:

Lundi - Vendredi : 9h - 17h

Samedi (matinée) : 9h - 13h

INP : 09 10 244 89

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE

Casablanca le 13-08-2021

Mr Hassan FASSI FIHRI
Prescripteur : Dr Abdellah BENNANI

Demande N° 2110300179

Analyses :

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E22	E
0106	Cholestérol total	B30	B
0108	Cholestérol H D L	B50	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0359	ACE	B250	B
0361	PSA	B300	B
0364	Ca 19 9	B400	B
0485	Microalbuminurie exprimée en gramme/gramme de créatinine	B150	B
	LDL calculé	B50	B

Total des B : 1550

TOTAL DOSSIER : 2100.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux mille cent dirhams

Dr. Nouredine LOUANJLI

المختبرات الطبية لـ
Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr. LOUANJLI Nouredine
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca
Tél.: 0522 20 74 222 / 0522 26 83 16

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40. Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - رب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

INP : 093001980
IF : 706552
ICE : 001654761000041

FACTURE

CASABLANCA le 13-08-2021

Mr Hassan FASSI FIHRI
Prescripteur : Dr Abdelilah BENNANI

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
	Serologie IgG COVID Vaccin	B130	B

Total des B : 130

TOTAL DOSSIER : 300.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cents dirhams .

Dr Nouredine LOUANJLI

مختبر التحليلات الطبية ليوماك
Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr. LOUANJLI Nouredine - Biologiste
10, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca
Tél : 0522 20 74 22 22 14 95 - Fax : 0522 26 83 03

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40. Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. رب. محج الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - رب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Date du prélèvement : 13-08-2021 à 10:46
Code patient : 1907120131
Né(e) le : 29-05-1962 (59 ans)

Mr Hassan FASSI FIHRI
Dossier N° : 2110300179
Prescripteur : Dr Abdelilah BENNANI



BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeûn

(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)

1.93 g/L (0.70-1.10)
10.71 mmol/L (3.89-6.11)

04-03-2021

1.45


Hémoglobine glyquée par HPLC

(Tosoh G8-HPLC)

7.3 % (4.0-6.0)

17-07-2021

7.8

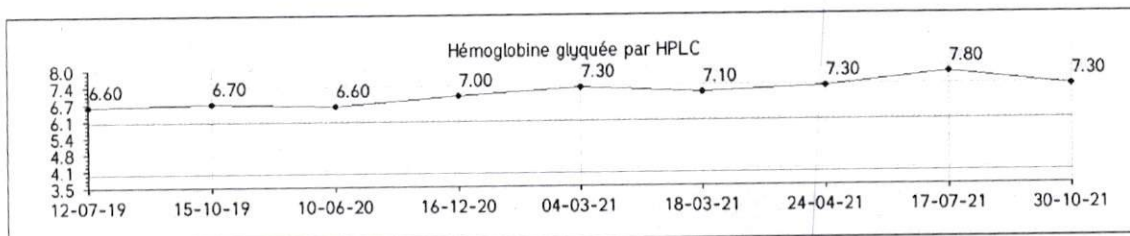

Les pièges de l'HbA1c:

1- Les situations qui surestiment le dosage de l'HbA1c :

Hypertriglycéridémie, insuffisance rénale/hyperurémie (Hb carbamylée), déficit en fer (anémies), vitamine b12, folates, splénectomie, abus d'opiacés, d'alcool ou d'acide acétylsalicylique, hyperbilirubinémie, présence d'hémoglobine foetale HbF (thalassémie).

2- Les situations qui sous-estiment le dosage de l'HbA1c :

Vitamines C et E, maladie hépatique chronique, hémodialyse, hémolyse, transfusion sanguine, présence d'HbS et C (facilement dépitées grâce au dosage par HPLC), splénomégalie, médicaments : dapson, antiviraux, interféron, fer, EPO et grossesse.

Créatinine

(Dosage cinétique - Roche Diagnostics Cobas)

9.3 mg/L (5.0-13.0)
82.3 µmol/L (44.3-115.1)

29-06-2021

7.7

"Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge, du sexe, état physiologique du patient(e)"

Au cours de l'IR (aiguë ou chronique), la créatininémie (Cr) peut rester longtemps dans les fourchettes des valeurs usuelles alors que le D.F.G est très diminué. Pour cette raison, l'ANAES recommande que l'estimation du D.F.G soit associée à chaque dosage du Cr.

Cholestérol total

(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)

1.90 g/l (1.30-2.30)
4.91 mmol/L (3.36-5.95)

04-03-2021

2.37

HDL-Cholestérol

(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)

0.47 g/L (0.42-0.92)
1.22 mmol/L (1.09-2.38)

04-03-2021

0.51

LDL-Cholestérol

(Calculé selon la formule de Friedwald)

1.22 g/L
3.16 mmol/L

04-03-2021

1.67

(sont considérés comme facteurs de risque : Diabète, Tabac, HTA, Obésité, Age > 60 ans, HDL < 0,40 g/L, Sédentarité, ATCD de maladie cardiovasculaire familiale.)

Valeurs cibles du LDL-Cholestérol selon les recommandations ANSM de mars 2005 :

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95 / 06 61 78 93 98

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله - الدا البيضاء - رب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

Validé par Dr. Nouredine LOUANJLI
Dr. LOUANJLI Nouredine
Pr. Prince Moulay Abdellah - Cas.
Tél : 0522 20 74 22 22 14 95 - Fax : 0522 26 83 03

Page 1 / 4

MAROC DIABETE PLUS

94 Rue ABOU ASSALT AL ANDALOUSSI - MAARIF
CP : 20100
Casablanca Maroc
Tél : 0522 23 76 76 / 23 75 24 / 98 44 65
Email : marocdiabete@menara.ma

Facture N° : FA21/4128

DATE

CLIENT

PAGE

00689

1 / 1

MAROC DIABETE Plus
94, Rue Abou Assalt Al Andaloussi
Maarif - Casablanca
Tél : 05 22 13 76 76 - Fax : 05 22 98 45 89
Service Commercial

MR EASSI FIIHRI HASSAN

Code	Désignation de l'article	Qté	P.U TTC	P.T TTC
GS260/25	B.L N° : BL21/5497 BANDELETTE BIONIME GS260 BTE 25	10.00	80,00	800,00

MAROC DIABETE Plus
94, Rue Abou Assalt Al Andaloussi
Maarif - Casablanca
Tél : 05 22 13 76 76 - Fax : 05 22 98 45 89
Service Commercial

Net H.T	TAUX	T.V.A
666.66	20%	133.33
TOTAL		TOTAL
666.67		133.33

Montant HT	666.67
Montant TVA	133.33
Montant TTC	800.00

Arrêtée la présente facture à la somme de :
HUIT CENT DIRHAMS.

PHARMACIE NOUR

10B, Ag Yacoub El Mansour et Sidi Abderrahmane Casablanca

Mme SOUMIA KABBAJ

Tel : 022368911

FASSI Fihri Hassan

Facture no : 13828

Le : 09/11/2021

Quantité	Désignation	Prix	Montant
5,00	GALVUS 50 MG /1000 CPS	390,00	1 950,00
3,00	JARDIANCE 25 MG BT 30 CP	550,00	1 650,00
2,00	NEBILET CP	87,50	175,00
3,00	TAREG 160MG BT/28 CP	180,30	540,90
3,00	CRESTOR 5 MG / 28 CP PEL	114,10	342,30
TVA	269.36	Total	4 658,20

Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT DIRHAMS ET VINGT CTS

	Taux	HT	TVA	TTC
0%Ar92	0,00	1 622,70	0,00	1 622,70
7.00%	7,00	1 983,74	1 051,76	3 035,50
		3 606,44	1 051,76	4 658,20

PHARMACIE NOUR
KABBAJ Soumia
10B, Ag Yacoub El Mansour
et Sidi Abderrahmane Casablanca
Tél : 0522 36 89 12 / 11